

ARDB 0011

(4533)

COMUNE DI
BOLZANO

**LIBRETTO METROLOGICO
DELL'ETILOMETRO**

Dräger Safety

ALCOTEST 7110 MKIII

DECRETO MINISTERIALE 22.5.1990, n° 196

Dräger Safety

ALCOTEST 7110/MKIII



Dräger

Dräger Safety Italia SpA: 20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7

Tel. 02-48610900 - Fax 02-48602464

Assistenza Tecnica: Tel. 02-48610900 (int. 917) - Fax 02-48602464

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO
DI TIPO OMOLOGATO**

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato


OM **00308Bet** del **10.11.1999**

Tipo: **ALCOTEST 7110 MKIII**

N° di serie: **ARDB-0011**

Dichiarazione n°: _____

Data: _____

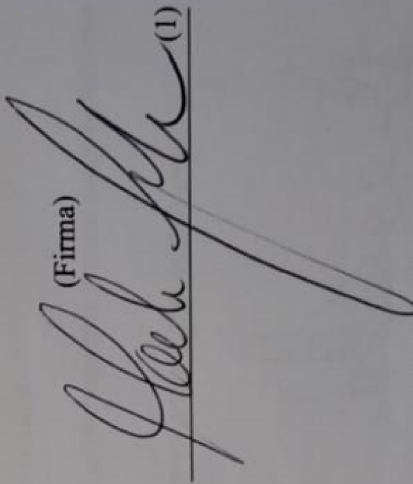(Firma)

_____ (1)

(1) depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / PERIODICA (*)

CENTRO PROVE AUTOVEICOLI
Via M. U. Traiano, 40
20149 MILANO

LABORATORIO:

DATA:


18 APR 2025
18 APR 2025

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore banco	Esito della verifica periodica			
	[mg/l] [g/l]	1,5l in 5s paller 3s	3l in 5s paller 3s	4,5l in 5s paller 3s	3l in 5s paller 1,5s
0,000	0,000 0,000		B		
0,200	0,200 0,460		B		
0,350	0,350 0,805		B		
0,400					
0,700	0,699 1,609		B		
0,950					
1,500	1,501 3,453		B		
2,500		B=risultati esatti; E=risultati che superano l'errore max CPA Milano, coordinato col C.S.R.P.A.D. di Roma			K 891
	Milano	18/04/2025			

riempire le caselle interessate {
con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/~~RESPINTO~~ (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile



VISTO
Maddalena Bennardo

(firma del responsabile del laboratorio)